


# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## PM 620

Le gestionnaire de piscine : Tous les paramètres de la piscine dans un seul instrument

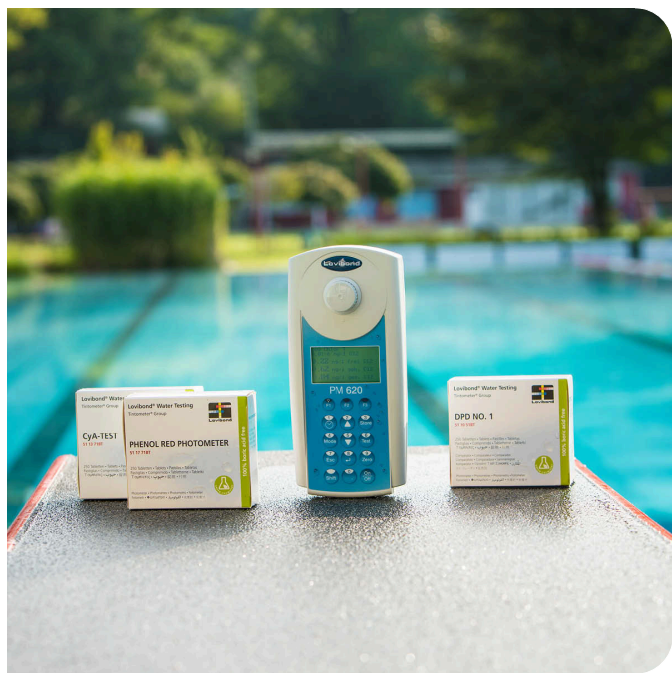

- Commande intuitive
- Écran éclairé
- Guide de l'utilisateur en allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais, polonais & indonésien
- Sauvegarde de jusqu'à 1 000 articles

Code: 214065

### Grande mémoire

Les appareils de la série PM 6xx enregistrent jusqu'à 1 000 articles.

### Technologie moderne

Les données sont transmises par infrarouge (PM 600 / PM 620) ou **Bluetooth®** (PM 630). Les appareils PM 600 et PM 620 sont connectés au PC via un module. Le PM 630 utilise **Bluetooth®** pour se connecter à l'application AquaLX®.

### Tous les paramètres importants

Les paramètres les plus importants de la piscine sont mesurés, de A (alcalinité-m) à V(anadium). L'utilisateur dispose au choix de 10 (PM 600) ou 34 paramètres (PM 620 / PM 630).

### Écran éclairé

L'appareil ne recule pas devant le noir : Les appareils ont tous un écran éclairé. Vous pouvez donc agir partout, même dans le noir.

### Flexibilité

Choisissez parmi les multiples versions proposées - pastille de réactif, indicateur liquide ou poudre de réactif : avec la série PM 6xx, vous pouvez utiliser tous les types de réactifs.

### Industrie

Piscines publiques | Services autour des piscines

### Applications

Aliments et boissons | Contrôle de la désinfection | Contrôle de l'eau de la piscine | Eau de chaudière | Eau de refroidissement | Galvanisation | Others | Traitement de l'eau brute | Traitement de l'eau potable | Traitement des eaux usées

### PM 620

Les photomètres PM 600 et PM 620 remplissent toujours les exigences des exploitants de piscines. Les appareils sont équipés d'un maximum de 34 méthodes et d'une mémoire prévue pour maximum 1 000 articles. Les données du PM 630 ne sont pas transmises par infrarouge mais via Bluetooth®. La commande intuitive et un écran éclairé rendent cette série d'appareils particulièrement conviviale.

## Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure	Méthode chimique
Alcalinité-m HR T	5 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Acide / Indicateur
Alcalinité-m T	5 - 200 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Acide / Indicateur
Aluminium PP	0.01 - 0.25 mg/L Al	Eriochrome cyanine R
Aluminium T	0.01 - 0.3 mg/L Al	Eriochrome cyanine R
Ammonium T	0.02 - 1 mg/L N	Indophénol Bleu
Brome T	0.05 - 13 mg/L Br <sub>2</sub>	DPD
Chlore (libre) et Monochloramine	0.02 - 4.50 mg/L Cl <sub>2</sub>	Indophenole method
Chlore HR PP	0.1 - 8 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Chlore HR T	0.1 - 10 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Chlore L	0.02 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Chlore MR PP	0.02 - 3.5 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Chlore PP	0.02 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Chlore T	0.01 - 6.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Cuivre PP	0.05 - 5 mg/L Cu	Bicinchoninate
Cuivre T	0.05 - 5 mg/L Cu <sup>a)</sup>	Biquinoline
CyA HR T	10 - 200 mg/L CyA	Mélatamine
CyA T	10 - 160 mg/L CyA	Mélatamine
Dioxyde de chlore T	0.02 - 11 mg/L ClO <sub>2</sub>	DPD / Glycine
Dureté Ca et Mg L	0.05 - 4 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Calmagite
Dureté calcique 2T	20 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Murexide
Dureté totale HR T	20 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub> <sup>1)</sup>	Métalophtaléine
Dureté totale T	2 - 50 mg/L CaCO <sub>3</sub>	Métalophtaléine
Fer T	0.02 - 1 mg/L Fe	Ferrozine / Thioglycolate
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> HR L	40 - 500 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	Tétrachlorure de titani-um/acide
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> T	0.03 - 3 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	DPD / Catalyseur
Hypochlorite de sodium T	0.2 - 16 % NaOCl	Sodiumiodide
Iode T	0.05 - 3.6 mg/L I <sub>2</sub>	DPD
K <sub>S4.3</sub> T	0.1 - 4 mmol/L K <sub>S4.3</sub>	Acide / Indicateur
Oxygène actif T	0.1 - 10 mg/L O <sub>2</sub>	DPD
Ozone T	0.02 - 2 mg/L O <sub>3</sub>	DPD / Glycine
PHMB T	2 - 60 mg/L PHMB	Tampon/Indicateur
Phosphate LR T	0.05 - 4 mg/L PO <sub>4</sub>	Bleu phosphomolybdique
Sulfate PP	5 - 100 mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	Sulfate de baryum - turbidité
Sulfate T	5 - 100 mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	Sulfate de baryum - turbidité
Urée T	0.1 - 2.5 mg/L Urea	Indophénol / Uréase
Valeur du pH HR T	8.0 - 9.6 pH	Bleu de thymole
Valeur du pH L	6.5 - 8.4 pH	Rouge de phénol
Valeur du pH LR T	5.2 - 6.8 pH	Bromocresolpurple
Valeur du pH T	6.5 - 8.4 pH	Rouge de phénol

## Fiche technique

<b>Optique</b>	Diodes lumineuses - photodétecteur - disposition par paire dans la cage de mesure transparente. Plages de longueur d'onde : 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δλ = 5 nm 610 nm IF Δλ = 6 nm IF = filtre interférentiel
<b>Précision longueurs d'onde</b>	± 1 nm
<b>Flacons adaptés</b>	Cuvettes rondes 16 mm Cuvettes rondes 24 mm Multi vial 10 mm
<b>Display</b>	Écran graphique
<b>Interfaces</b>	Infrarouge
<b>Fonctionnement</b>	Clavier à membrane résistant aux acides et solvants avec retour d'info acoustique via avertisseur sonore intégré
<b>Mises à jour</b>	Mises à jour du logiciel sur Internet
<b>Stockage interne</b>	env. 1 000 articles
<b>Durée de vie batterie</b>	env. 26 h
<b>Beeper</b>	existant
<b>Portabilité</b>	Benchtop
<b>Conformité</b>	CE
<b>Langues interface d'utilisateur</b>	Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Polonais, Indonésien
<b>Dimensions</b>	95 x 45 x 210 mm

## Contenu de livraison

- Livré dans une mallette
- 4 piles (AA)
- 3 cuves 24 mm Ø
- Bêcher de mesure 100ml
- Agitateur en plastique
- Brosse
- Seringue
- Réactifs pour chlore (libre, combiné, total)
- Valeur du pH
- Dureté calcique
- Capacité acide KS4.3 (alcalinité-M)
- Mode d'emploi
- Certificat (COC) et conditions de garantie

Titre	Code
Échantillonneur d'eau et bouteille de 250 ml	170500
Piles (AA), lot de 4	1950025
Multi-cuves 3, lot de 12	197605
Cuve ronde avec couvercle Ø 24 mm, hauteur 48 mm, 10 ml, lot de 12	197620
Joint pour cuves rondes 24 mm, lot de 12	197626
Cuve ronde avec couvercle Ø 24 mm, hauteur 48 mm, 10 ml, lot de 5	197629
Chiffon de nettoyage	197635
Cuve ronde avec couvercle Ø 16 mm, hauteur 90 mm, 10 ml, lot de 10	197665
Adaptateur pour cuves rondes 16 mm	19802190
Câble de mise à jour pour connexion à un PC	214030
Câble de mise à jour Set avec adaptateur USB/R232	214031
Kit d'étalons de référence Chlore 0,2 et 1,0 mg/l (MD/PM 600 series)	215630
Kit d'étalons de référence Chlore 0,5 et 2,0 mg/l (MD/PM 600 series)	215635
Kit d'étalons de référence Chlore 1,0 et 4,0 mg/l (MD/PM 600 series)	215636
Kit d'étalon de référence pH 7,45 (MD/PM 600 series)	215665
Kit étalons de contrôle PM Photomètre	215680
Agitateur en plastique, longueur 13 cm	364100
Agitateur en plastique, longueur 10 cm	364109
Boîte de 10 agitateurs en plastique	364120
Boîte de 10 agitateurs en plastique	364130
Seringue en plastique, 5 ml	366120
Flacon de 250 mL avec bouchon	375072
Gobelet de mesure, 100ml	384801
Porte-cuves pour 6 cuves rondes Ø 24 mm	418951
Entonnoir en plastique avec anse	471007
ValidCheck Chlore 1,5 mg/l	48105510

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

#### Tintometer China

9F, SOHO II C. No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care Tel.: +86 (021) 69910081  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

#### Lovibond Tintometer Sdn Bhd

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Batu Nilam 2, Bdr Bkt Tinggi,  
41200, Klang, Selangor,  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne